

ORIGINAL ARTICLE

Designing an ELISA Method for Measurement of Human IgG and IgM Antibodies against SARS-CoV-2

Saeid Taghiloo¹,
Mina Dabiri²,
Reza Valadan³,
Hossein Asgarian-Omran⁴

¹ PhD in Medical Immunology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

² MSc in Medical Immunology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

³ Assistant Professor, Department of Immunology, Molecular and Cell-Biology Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

⁴ Associate Professor, Department of Immunology, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received October 31, 2022 ; Accepted May 29, 2022)

Abstract

Background and purpose: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a respiratory disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). In this study, an indirect ELISA method was designed to measure the human IgM and IgG antibodies against SARS-CoV-2.

Materials and methods: Protein sequence of nucleocapsid antigen from SARS-CoV-2 was expressed in *E. coli* BL21 and then was purified by chromatography. The purified protein was confirmed by SDS-PAGE and Western blotting. An indirect ELISA method was designed to measure the specific IgG and IgM antibodies against SARS-CoV-2 using recombinant N protein. The optimized ELISA method was then applied to measure the IgG and IgM antibodies in 61 infected or recovered COVID-19 patients and in 31 healthy controls. Finally, data obtained from the designed ELISA method were compared with those of a commercially approved ELISA kit.

Results: The recombinant nucleocapsid protein was successfully expressed and purified which was confirmed by SDS-PAGE and Western blotting. The amount of optical densities obtained from the designed ELISA method was similar to those of the commercial kit in 61 patients and 31 controls. The sensitivity and specificity of the designed ELISA method for IgG were 100% compared with the commercial ELISA kit, while the sensitivity and specificity for IgM were 96.72 and 96.77, respectively.

Conclusion: Serological tests alone are not suitable for diagnosis; however, their combination with molecular tests increases the accuracy and sensitivity of the COVID-19 diagnosis. These tests are also valuable for epidemiological studies.

Keywords: nucleocapsid, IgG, IgM, ELISA, SARS-CoV-2

J Mazandaran Univ Med Sci 2022; 32 (210): 26-36 (Persian).

Corresponding Author: Hossein Asgarian-Omran - Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. (E-mail: asgarianhossein@yahoo.com)

طراحی روش ELISA برای سنجش آنتی بادی های IgM و IgG انسانی علیه SARS-CoV-2

سعید تقی لو^۱مینا دبیری^۲رضا ولدان^۳حسین عسگریان عمران^۴

چکیده

سابقه و هدف: بیماری کووید-۱۹، یک بیماری تنفسی است که به وسیله‌ی گونه‌ای از کروناویروس تحت عنوان SARS-CoV-2 ایجاد می‌شود. این مطالعه با هدف طراحی یک روش الایزای غیرمستقیم برای سنجش آنتی بادی های IgM و IgG علیه SARS-CoV-2، انجام پذیرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، توالی پروتئین نوترکیب نوکلئوکپسید SARS-CoV-2 در باکتری E. coli BL21 بیان شد. پروتئین تولیدی با استفاده از SDS-PAGE و وسترن بلاستینگ تایید شد. در ادامه، از پروتئین نوترکیب نوکلئوکپسید تولید شده، روش غیرمستقیم برای سنجش آنتی بادی های IgG و IgM علیه SARS-CoV-2 طراحی شد. سپس از این روش برای سنجش آنتی بادی های IgM و IgG در ۶۱ بیمار مبتلا یا بهبود یافته از بیماری COVID-19 به همراه ۳۱ نمونه سرم فرد سالم استفاده شد. در انتها نتایج بدست آمده از روش ELISA طراحی شده بر روی نمونه‌ها با کیت تجاری مورد تایید و زارت بهداشت مقایسه شد.

یافته‌ها: پروتئین نوترکیب نوکلئوکپسید بیان و تخلیص شد و سپس به کمک SDS-PAGE و وسترن بلاستینگ مورد تایید قرار گرفت. میزان جذب نوری بدست آمده از روش ELISA طراحی شده در ۶۱ بیمار و ۳۱ فرد سالم در مقایسه با کیت تجاری هم راستا بوده است. حساسیت و ویژگی روش ELISA طراحی شده برای سنجش IgG ۱۰۰ درصد تعیین شد، این در حالی است که حساسیت ۷۷/۶۶ و ویژگی ۷۷/۶۶ برای سنجش IgM گزارش شد.

استنتاج: تست‌های سرولوژیک به تنها بی ارزشی مناسب برای تشخیص نیستند، با این حال همراهی با تست‌های مولکولی موجب افزایش صحت و حساسیت در تشخیص بیماری می‌شود. همچنین این آزمایشات برای بررسی های اپیدمیولوژیکی بسیار ارزشمند می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: نوکلئوکپسید، IgG، IgM، الایزا، سارس کرونا ویروس-۲

مقدمه

ویروس سارس کرونا ۲ (SARS-CoV-2) بعد از (Sever Acute Respiratory Syndrome) ویروس سارس (Coronaviridae) جدیدترین عضو از خانواده کرونا ویریده (Middle-East Respiratory Syndrome) و مرس (MERS)،

- E-mail: asgarianhossein@yahoo.com
- مؤلف مسئول: حسین عسگریان عمران** - ساری: کیلومتر ۱۷ جاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پامبر اعظم، دانشکده پزشکی
۱. دکترای تخصصی ایمونولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 ۲. کارشناس ارشد ایمونولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 ۳. استادیار، گروه ایمونولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 ۴. دانشیار، گروه ایمونولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات دستگاه گوارش، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
- تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۸/۹ تاریخ ارجاع چهت اصلاحات: ۱۴۰۰/۱۲/۱ تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۳/۸

نمود(۱۱). در حال حاضر از تکنیک های Real Time-PCR و سرولوژی برای بررسی بیماران مشکوک به عفونت SARS-CoV-2 کمک گرفته می شود(۱۲،۱۱). آزمایش مولکولی RT-PCR که به یک روش استاندارد برای تشخیص عفونت SARS-CoV-2 از زمان شناسایی این ویروس تبدیل شده است، دارای محدودیت های بسیاری بوده و میزان بالایی از نتایج منفی کاذب از آن گزارش شده است(۵). تکنیک RT-PCR در مراحل اولیه عفونت ویروسی که در آن ویروس به سرعت در حال تکثیر بوده ایفا نمی کند، که تشخیص مستقیم پاتوژن را امکان پذیر می کند(۱۳). در شرایط بهبودی بیمار و همچنین کاهش میزان تکثیر ویروس، امکان شناسایی دقیق و صحیح تعداد زیادی از بیماران آلوده، افراد ناقل بدون علامت و همچنین تشخیص عفونت احتمالی COVID-19 در بیماران بهبود یافته وجود ندارد(۱۳). آزمایشات سرولوژیک توانایی شناسایی آنتی بادی های مختلف علیه ویروس در خون و سایر مایعات بدن را دارند. برخلاف RT-PCR آزمون های مبتنی بر شناسایی ژنوم ویروس مانند که پس از پاکسازی ویروس کارا نخواهد بود و از آن جا که آنتی بادی های تولید شده در بدن میزبان تا مدت ها باقی می مانند، لذا آزمایش های سرولوژیکی مبتنی بر اندازه گیری آنتی بادی اختصاصی علیه ویروس توانایی شناسایی طیف وسیعی از بیماران، افراد بهبود یافته از این بیماری و همچنین افراد ناقل بدون علامت را دارد(۱۴). لذا این آزمون ها در بررسی های سروایپدمیولوژیکی و تعیین میزان تماس افراد جامعه با این ویروس بسیار کمک ELISA کننده خواهند بود. در این راستا، چند کیت از SARS-CoV-2 برای تشخیص آنتی بادی های ضد IgA و IgM توسط شرکت های معتبر کلاس های IgA، IgM و IgG بین المللی ارائه شده است. شناسایی آنتی بادی های IgG نشان دهنده یک عفونت مداوم یا حتی گذشته است، در حالی که آنتی بادی های IgM و IgA به عنوان نشانگرهای اولیه عفونت های حاد دستگاه تنفسی توصیف می شوند(۱۴). با توجه به اپیدمی گسترده این بیماری در ایران، این

است که موجب طیفی از بیماری ها به ویژه پنومونی های کشنده در انسان می شود و عامل همه گیری اخیر در سطح جهان است(۲،۱). ویروس SARS-CoV-2 در دسامبر سال ۲۰۱۹ توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان عامل Coronavirus Disease of 2019(COVID-19) معرفی شد(۲،۱). ویروس SARS-CoV-2 یک ویروس RNA دار است که به طور گسترده در انسان و سایر پستانداران و پرنده های پخته می شود و سبب بیماری های سیستم تنفسی، روده، کبد و اعصاب می شود(۳). علائم شایع در افراد آلوده به ویروس SARS-CoV-2 شامل علائم تنفسی، تب و سرفه خشک بوده و در موارد شدیدتر، عفونت می تواند منجر به پنومونی و سندروم حاد تنفسی شود(۴). مسیر های شناخته شده انتقال بیماری COVID-19 توسط قطرات تنفسی و انتقال تماسی است، در حالی که آتروسل و انتقال مدفعی دهانی نیز گزارش شده است(۵). ویروس SARS-CoV-2 دارای آنتی ژن های متعدد بوده که از مهم ترین آن ها می توان به آنتی ژن های Spike (S)، Membrane (M)، Envelope (E) و Nucleocapsid (N) اشاره نمود(۷،۶). از این میان، دو آنتی ژن S و N بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. پروتئین S یک پروتئین سطحی ویروس است که پس از سنتز گلیکوزیله شده و به صورت ساختارهای سه تایی در سطح ویروس قرار می گیرد. دومین های مختلف این پروتئین در اتصال ویروس به رسپتور سلولی و فیوژن نقش دارند، پروتئین N یک فسفو پروتئین دارای دومین های متصل شونده به RNA است که پس از اتصال به ژنوم ویروسی، نوکلئو کپسید مارپیچی ویروس را شکل می دهد و به جای گیری نوکلئو کپسید شکل گرفته در ذره ویروسی منجر می شود(۹،۸). هر دو پروتئین S و N قادر به القای پاسخ ایمنی در بدن انسان بوده و در تست های سرولوژیک جهت تشخیص ویروس به کار می روند(۱۰). برای تشخیص این بیماری همانند سایر بیماری های عفونی، می توان از آزمایشات مختلف مبتنی بر شناسایی ژنوم ویروس و همچنین سنجش آنتی ژن ها و آنتی بادی های علیه آن استفاده

نوترکیب به باکتری‌های *E-coli* از کلون‌های رشد کرده در محیط LB براث به صورت شبانه، ۵۰ میکرولیتر به ۵ میلی‌لیتر محیط LB براث استریل حاوی آنتی‌بیوتیک کانامایسین منتقل گردید. با توجه به این که بیان پروتئین نوترکیب در سویه BL21 تحت کنترل اپرون lac می‌باشد، پس از این که جذب نوری محیط کشت در طول موج ۶۰۰ نانومتر به حدود ۰/۵ رسید، برای القای بیان پروتئین از ایزوپروپیل- β -D-1-گالاکتوپیرانوزید (IPTG) با غلاظت ۰/۵ میلی‌مolar استفاده شد. پس از آن سلول‌ها به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد و سرعت ۱۲۰ rpm در شیکر انکوباتور نگهداری گردید. نتایج بیان بر روی ژل ۱۲ درصد SDS-PAGE بررسی گردید. برای تخلیص پروتئین از ستون نیکل-نیتریلو استیک اسید (Ni-NTA) استفاده شد. با توجه به این که پروتئین نوترکیب حاصل به صورت نامحلول بود، قبل از عبور از ستون با استفاده محلول اوره ۸ مولار پروتئین نامحلول به حالت محلول تبدیل گردید. پس از عبور دادن عصاره سلولی از ستون تمایلی، از بافر حاوی ایمیدازول ۴۰ میلی‌مولار برای سستشو و از بافر حاوی ایمیدازول ۲۵۰ میلی‌مولار به عنوان بافر الوشن خارج کننده پروتئین نوترکیب استفاده گردید. جهت تایید تخلیص پروتئین نوترکیب، خروجی‌های ستون بر روی ژل ۱۲ درصد SDS-PAGE الکتروفورز شد. پس از تخلیص پروتئین به منظور حذف ایمیدازول و تا خوردگی مجدد پروتئین پس از مواجهه با اوره، از روش دیالیز استفاده شد. برای این منظور، بشر حاوی بافر PBS و کیسه دیالیز محتوی نمونه روی همزن مغناطیسی قرار داده شد و بافر به طور دائم با استفاده از مگنت یکنواخت گردید. این کار در دمای اتاق به صورت شبانه انجام گرفت. پس از طی این مراحل، محتویات کیسه دیالیز سانتریفیوژ شد و رسوب مایع رویی جداگانه بر روی SDS-PAGE الکتروفورز گردید. در مرحله بعد به منظور تخلیص نهایی پروتئین موردنظر، محلول رویی به دست آمده از مرحله قبل، از فیلترهای آمیکون با منافذ ۱۰ کیلو دالتونی عبور داده شد.

مطالعه با هدف تولید نوترکیب آنتی‌ژن ویروس یک روش الیزای مناسب برای سنجش آنتی‌بادی‌های IgM و IgG علیه SARS-CoV-2 طراحی گردید که در ادامه این آزمایش در جهت تشخیص و پایش بیماران مبتلا و همچنین بررسی سروابیدمیولوژی جمعیت‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

مواد و روش‌ها

تولید و تخلیص آنتی‌ژن نوکلئوکپسید ویروس ۲۰۱۹ در این مطالعه تجربی، با کد اخلاق COPE دستورالعمل کمیته اخلاق کشوری و آینه نامه IR.MAZUMS.REC.1399.114 رعایت شد، و توالی ژن نوکلئوکپسید کرونا ویروس جدید که در بانک اطلاعاتی NCBI موجود می‌باشد، استخراج گردید. این ژن ۱۲۶۰ نوکلئوتید بوده و پروتئین تولیدی آن به طول ۴۱۹ اسید آمینه می‌باشد. به منظور تولید پروتئین نوکلئوکپسید، از پلاسمید بیانی pET-28 حاوی توالی His-tag استفاده شد. توالی مورد نظر جهت سنتز و کلوبینگ در وکتور بیانی 28-pET به شرکت ارسال شد. در ابتدا، سویه باکتری Genscript Biotech LB (*E-coli* BL21 (DE3)) به مدت ۱۵ ساعت در محیط مایع بدون آنتی‌بیوتیک در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد و با هواهدی در سرعت ۲۵۰ دور در دقیقه انکوبه شد. ۵۰۰ میکرو لیتر از محیط کشت فوق به ۵۰ میلی‌لیتر محیط LB مایع تلقیح و در شیکر انکوباتور با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد و ۲۵۰ دور در دقیقه انکوبه شد. پس از این که جذب نوری محیط کشت در طول موج ۶۰۰ نانومتر به ۰/۵ رسید، رسوب سلولی جمع‌آوری و با استفاده از کلرید کلسیم ۱۰۰ میلی‌مولار، سلول‌های مستعد تنهی شدند. پلاسمید بیانی نوترکیب حاوی ژن نوکلئوکپسید ویروس با روش شوک حرارتی به سلول‌های مستعد ترانسفورم شد. رسوب باکتری‌ها بر روی محیط LB آگار حاوی کانامایسین کشت داده شد و به مدت ۱۶ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه گردید. پس از تایید ترانسفورماتیون پلاسمید

خصوصیت آن، از آنتی ژن به دست آمده برای طراحی روش ELISA غیرمستقیم برای شناسایی آنتی بادی های اختصاصی علیه ویروس SARS-CoV-2 استفاده شد. برای انجام الایزای غیرمستقیم، هر چاهک پلیت ۹۶ تابی الایزا پس از بهینه سازی مراحل مختلف، با غلظت $5 \mu\text{g/ml}$ پروتئین نوترکیب نوکلئو کپسید در بافر PBS به صورت شبانه انکوبه کوت شد. پس از مرحله های بلاکینگ با کارزین ۱ درصد در بافر PBS به مدت ۱/۵ ساعت انکوبه روی شیکر، به چاهک ها ۱۰۰ میکرولیتر از سرم رقیق شده با رقت ۱/۱۰۰ گروه بیماران و کنترل اضافه گردید، و سپس به مدت ۱ ساعت انکوبه شدند. مرحله شناسایی توسط کونژو گه HRP متصل به آنتی بادی بزری ضد آنتی بادی انسانی (Sigma, Missouri, USA) به صورت انکوباسیون ۳۰ دقیقه ای در ۳۷ درجه سانتی گراد انجام گرفت. سپس از محلول سوبسترا - کروموزن TMB به عنوان ماده رنگکرزا در واکنش استفاده شد و از محلول اسید H_2SO_4 با نرمالیتی ۲ به عنوان محلول متوقف کننده واکنش استفاده شد. در انها چاهک ها با طول موج ۴۵۰ نانومتر به همراه ۶۳۰ نانومتر به عنوان طول موج رفرنس خوانش شد. بر اساس جذب نوری (OD) به دست آمده نتایج مورد تعزیز و تحلیل قرار گرفت. برای شناسایی IgG از کونژو گه اختصاصی anti-human IgG متصل به هر ۱۰۰، و برای شناسایی IgM از کونژو گه اختصاصی anti-human IgM متصل به HRP استفاده گردید.


مقایسه روش الایزای طراحی شده با نمونه کیت تجاری در سنجش آنتی بادی های اختصاصی علیه ویروس SARS-CoV-2

پس از طراحی روش ELISA غیرمستقیم، ویژگی های آزمون طراحی شده در شناسایی آنتی بادی های اختصاصی IgM و IgG علیه ویروس در مقایسه با کیت سنجش SARS-CoV IgM و سنجش SARS-CoV IgG شرکت دیازیست (تهران، ایران) مورد تایید وزارت بهداشت که در آن از پروتئین نوکلئو کپسید به عنوان

برای تایید خلوص و اختصاصیت پروتئین نوترکیب تولید و تخلیص شده، از روش های SDS-PAGE و وسترن بلاکینگ استفاده گردید. برای تایید پروتئین نوترکیب از anti-His-tag تکیک و سترن بلاکینگ با آنتی بادی anti-His-tag کونژو گه با HRP استفاده شد. عصاره سلولی نمونه تخلیص شده و پروتئین BSA به عنوان کنترل منفی بر روی ژل ۱۲ درصد SDS-PAGE الکتروفورز شدند. لکه گذاری بر روی کاغذ PVDF با استفاده از سیستم BioRad و بافر مخصوص انتقال حاوی گلایسین ۱۹۲ میلی مولار، تریس ۲۵ میلی مولار، SDS ۱ درصد و متانول ۲۰ درصد انجام شد. پس از اتمام انتقال و منتقل شدن ladder به کاغذ، کاغذ PVDF به مدت ۲ ساعت در محلول TBST حاوی ۵ درصد شیر خشک بر روی شیکر انکوبه گردید. سپس کاغذ ۲ مرتبه با TBST شستشو داده شد و به مدت ۲ ساعت در دمای اتاق با آنتی بادی ضد His-tag (HRP-conjugated mouse His-tag antibody) (سایتومتین ژن - اصفهان - ایران) با رقت ۱/۱۰۰۰ در حالت shaking انکوبه شد. آنتی بادی ها در محلول TBST رقیق شدند. پس از انکوباسیون با آنتی بادی، آنتی بادی خارج و کاغذ ۳ مرتبه و هر بار به مدت ۵ دقیقه با TBST شستشو داده شد. جهت نمایان کردن باندهای پروتئین های مورد نظر از کیت ECL (سایتومتین ژن) استفاده شد. میزان مساوی از یک میلی لیتر از محلول A و B کیت با یکدیگر مخلوط و به مدت ۳ دقیقه با کاغذ انکوبه گردید. کاغذ از محلول خارج و توسط دستگاه G:Box شرکت Syngene خوانده شد. در انتهای، با استفاده از روش BCA، پروتئین نوترکیب تولید شده تعیین غلظت گردید. در نهایت پروتئین تخلیص شده مورد نظر تا انجام آزمایشات دیگر در ۷۰ درجه سانتی گراد نگهداری شد.


طراحی روش ELISA غیرمستقیم برای شناسایی آنتی بادی های اختصاصی IgG و IgM علیه ویروس SARS-CoV-2 پس از خالص سازی آنتی ژن نوکلئو کپسید و تعیین

مولار جهت محلول کردن پروتئین تولیدی قبل از تخلیص استفاده شد (تصویر شماره ۲). نتایج حاصل از تخلیص پروتئین با استفاده از ستون Ni-NTA یانگر وجود پروتئین نوترکیب با وزن ۴۵ کیلو دالتون در خروجی شستشوی ایمیدازول ۲۵۰ میلی مولار با درجه خلوص بالا بود (تصویر شماره ۳). در انتهای، پس از تخلیص نهایی با استفاده از عبور از فیلتر آمیکون ۱۰ کیلو دالتون تغليظ گردید و سپس غلاظت پروتئین تولیدی با روش BCA محاسبه شد.

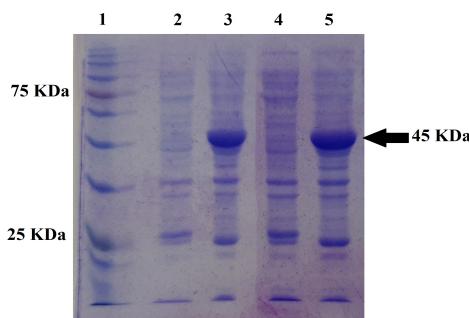

تصویر شماره ۱: الگوی الکتروفورز پروتئین بیان شده توسط باکتری روی ژل ۱۲ درصد SDS-PAGE

۱. نشانگر مولکولی پروتئین (Protein Ladder)
۲. عصاره باکتری القاء نشده با IPTG
۳. عصاره باکتری القاء شده با IPTG
۴. فاز محلول در باکتری های القاء شده با IPTG
۵. فاز غیر محلول در باکتری های القاء شده با IPTG

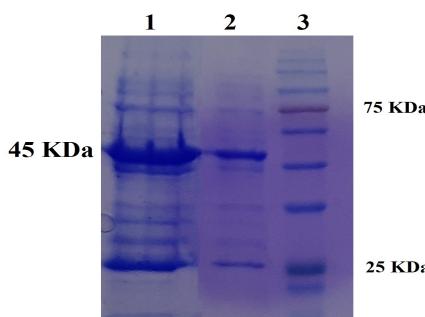

تصویر شماره ۲: الگوی الکتروفورز تبدیل پروتئین نامحلول به محلول با اوره ۸ مولار بر روی ژل ۱۲ درصد SDS-PAGE

۱. فاز محلول باکتری بعد از مواجهه با اوره ۸ مولار،
۲. فاز غیر محلول باکتری بعد از مواجهه با اوره ۸ مولار،
۳. نشانگر مولکولی پروتئین (Protein Ladder)

آنتی ژن و لایه اول الیزا استفاده شده بود، سنجیده شد. بدین منظور از ۶۱ نمونه سرم افراد بهبود یافته از بیماری COVID-19 (سرم مثبت) استفاده گردید. این افراد بیمارانی بودند که بهبود یافته و دارای آنتی بادی اختصاصی IgM و IgG علیه ویروس SARS-CoV-2 در خون خود بودند. همچنین از ۳۱ نمونه سرم افرادی که فاقد آنتی بادی اختصاصی می باشند (سرم منفی) نیز استفاده شد. در انتهای، پارامترهای مختلف حساسیت، ویژگی و تکرار پذیری برای روش طراحی شده در مقایسه با کیت تجاری مورد بررسی قرار گرفت.


تجزیه و تحلیل داده ها

در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزار Graphpad Prism-6 و SPSS-25 استفاده شد و برای بررسی همبستگی بین نتایج از آزمون پیرسون استفاده گردید. همچنین برای بررسی حساسیت و ویژگی روش طراحی شده از آنالیز ROC Curve استفاده شد.

یافته ها


بیان و تخلیص پروتئین نوکلئوکپسید ویروس SARS-CoV-2 با القای بیان پروتئین N تحت کنترل اپرون lac در شرایط انکوباسیون استاندارد، باکتری های القاء شده و القاء نشده جمع آوری و شکسته شدند. سپس کل محتوای پروتئینی باکتری روی ژل ۱۲ درصد SDS-PAGE الکتروفورز شد. در نمونه های القاء شده، پروتئین N با بیان بالا مشاهده گردید و در نمونه های القاء نشده باند مربوط به پروتئین هدف وجود نداشت (تصویر شماره ۱). بعد از بیان پروتئین، فاز محلول و نامحلول حاصل از سانتریفوژ لیزات سلولی، بر روی ژل ۱۲ درصد ۱ SDS-PAGE ران شد. همان طور که در تصویر شماره ۱ نشان داده شده است، باند بیانی مربوط به پروتئین مورد نظر در ستون مربوط به فاز نامحلول قابل رویت است و بنابراین بیان پروتئین به صورت کنجاله های نامحلول (Inclusion Bodies) است. به همین دلیل، از اوره ۸

مقایسه سنجش میزان آنتی بادی های IgM و IgG با استفاده از کیت طراحی شده و تجاری در ابتدا لایه های مختلف روش ELISA اعم از غلظت آنتی زن برای لایه کوتینگ، محلول بلاکینگ، محلول رقیق کننده نمونه سرم، رقت موردن استفاده از سرم و در نهایت رقت کونژو گه مورد نظر بهینه سازی شد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون های انجام شده سریالی مناسب ترین غلظت آنتی زن متصل شده به فاز جامد در هر دو روش سنجش IgG و IgM مقدار ۵ میکرو گرم بر میلی لیتر بود، که در حجم ۱۰۰ میکرولیتر در هر چاهک با بافر فسفات سالین (PBS) بهینه شد. در این مطالعه برای انتخاب محلول بلاکینگ مناسب از پروتئین های مختلفی از قبیل BSA، کازئین و ژلاتین با درصد های ۱ و ۳ در بافر PBS استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که مناسب ترین محلول بلاک کننده کازئین ۱ درصد در بافر PBS بوده است. همچنین بهترین رقت سرم به منظور شناسایی IgG و IgM پس از انجام آزمایش با رقت های مختلف سریالی از سرم، $1/100$ انتخاب گردید. علاوه بر این مناسب ترین تیتر آنتی بادی کونژو گه علیه IgG و IgM انسانی $1/300$ تعیین شد. پس از بهینه سازی آزمون ELISA با آنتی زن تولید شده در این مطالعه، سنجش آنتی بادی های IgG و IgM علیه SARS-CoV-2 برای ۶۱ فرد بیمار و ۳۱ فرد سالم به عنوان گروه کنترل مورد مطالعه انجام گرفت. به منظور بررسی صحت و دقیقت این روش طراحی شده، میزان آنتی بادی های IgG و IgM علیه SARS-CoV-2 با کیت تجاری مورد تایید وزارت بهداشت (شرکت دیازیست) مطابق پرتوکل شرکت سازنده سنجیده و با نتایج به دست آمده با روش طراحی شده مقایسه گردید. همان طور که در تصویر شماره ۵ مشاهده می شود، همبستگی کاملاً مثبت و معنی داری بین OD های بدست آمده در سنجش IgG و IgM با روش طراحی شده و کیت دیازیست وجود دارد. علاوه بر این، از آنالیز منحنی راک (ROC Curve) برای بررسی حساسیت و ویژگی روش طراحی شده در

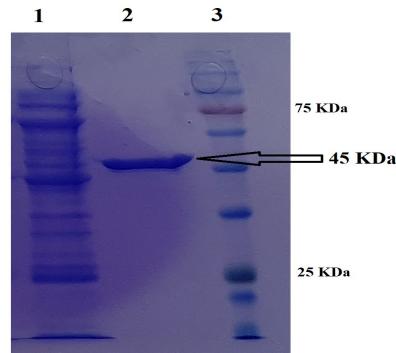

تصویر شماره ۳: الگوی الکتروفورز پروتئین نوترکیب تخلیص شده با ستون Ni-NTA بر روی ژل ۱۲ درصد SDS-PAGE. ۱. خروجی شستشوی ستون با ایمیدازول ۴۰ میلی مولار، ۲. خروجی الوشن ستون با ایمیدازول ۲۵۰ میلی مولار (پروتئین نوترکیب تخلیص شده) ۳. نشانگر مولکولی پروتئین (Protein Ladder).

تایید پروتئین نوترکیب با روش وسترن بلاکینگ با استفاده از آنتی بادی ضد His-tag در پایان به منظور بررسی صحت پروتئین نوترکیب N از آنالیز وسترن بلاکینگ استفاده شد. برای این منظور باند رنگ گرفته بر روی کاغذ نیترو سلولز در مقایسه با نمونه کنترل منفی (BSA) بررسی شد و مشخص گردید که باند رنگی مربوط به پروتئین N در جایگاه درست خودش در مقابل باند ۴۵ کیلو دالتونی نشانگر مولکولی پروتئین قرار گرفته است (تصویر شماره ۴).


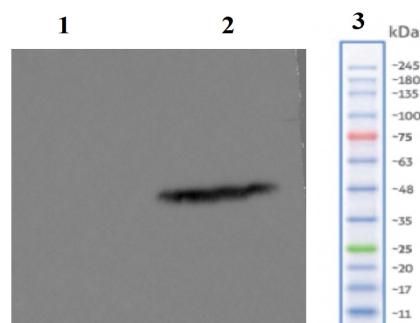


تصویر شماره ۴: تایید پروتئین نوترکیب با روش وسترن بلاکینگ و با anti-His-Tag antibody استفاده از ۱. کنترل منفی (پروتئین BSA)، ۲. پروتئین نوكلوكسپید نوترکیب تخلیص شده، ۳. نشانگر مولکولی پروتئین (Protein Ladder).


بحث

یکی از راههای کنترل همه‌گیری SARS-CoV-2 تشخیص سریع افراد آلوده و جداسازی آنها از افراد دیگر جامعه برای جلوگیری از انتقال ویروس به افراد سالم است. همان‌طور که اشاره شد، روش‌های کنونی شامل است. همان‌طور که اشاره شد، روش‌های تشخیص شامل تست‌های مولکولی، CT Scan، روش‌های سرولوژی و بررسی فاکتورهای خونی می‌باشد^(۱۵). از بین این روش‌ها، تست مولکولی مطمئن‌ترین روش جهت تایید حضور ژنوم ویروس است، اما این روش با محدودیت‌هایی همراه است که از جمله آنها می‌توان به زمان بر بودن آماده شدن نتایج، نیازمندی به فضای آزمایشگاهی مناسب، تجهیزات گران قیمت و نیروی کار با تجربه و آموزش دیده و نتایج منفی کاذب به علت جمع‌آوری نامناسب نمونه‌ها یا استخراج نامناسب اسید نوکلئیک اشاره کرد^(۱۴,۱۶). از طرف دیگر، تست‌های مولکولی نیز فقط قدرت تشخیص عفونت فعلی را دارند و برای مطالعات گذشته‌نگر مناسب نیستند. به طوری که نتیجه منفی این تست برای یک فرد می‌تواند به هر دو صورت ابتلا نشدن به ویروس یا ابتلا به ویروس و عبور از مرحله فعلی عفونت و بهبودی تفسیر شود. بنابراین تست‌های مولکولی روشی مناسب برای غربالگری افراد جامعه و تشخیص‌های ساده، ارزان قیمت و سریع نیستند و استفاده از روش‌های سریع تر و ارزان‌تر یک نیاز ضروری است^(۱۴,۱۷). همان‌طور که اشاره شد، پاسخ ایمنی و آتنی‌بادی تولید شده علیه ویروس اختصاصی است و تا مدتی در بدن باقی می‌ماند، بنابراین، بررسی آن می‌تواند به عنوان یک راهکار در تشخیص مطرح باشد. طراحی تست‌های سرولوژیکی از قبیل ELISA به گونه‌ای است که علاوه بر سرعت آماده شدن نتیجه تست، انجام تست به تجهیزات گران و نیروی کار با تجربه چندان وابسته نیست، بنابراین مقرر به صرفه ترند و نمونه‌گیری برای این تست‌ها، با توجه به استفاده از خون کامل یا سرم، سخت و تهاجمی نیست. همچنین به دلیل پایداری پاسخ‌های ایمنی، این تست‌ها برای مطالعات گذشته نگر

برابر روش استاندارد (کیت دیاژیست) انجام گرفت. نتایج این آنالیز حاکی از این بود که سنجش IgG با روش طراحی شده دارای حساسیت ۱۰۰ درصد و ویژگی ۱۰۰ درصد بوده است (تصویر شماره ۶). همچنین حساسیت ۹۶/۷۷ درصد و ویژگی ۹۶/۷۷ درصد برای سنجش IgM با روش طراحی شده گزارش شد (تصویر شماره ۶).

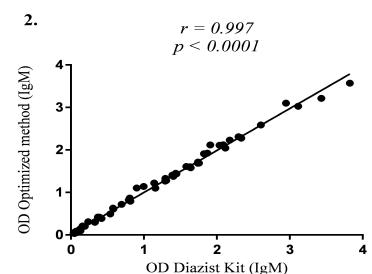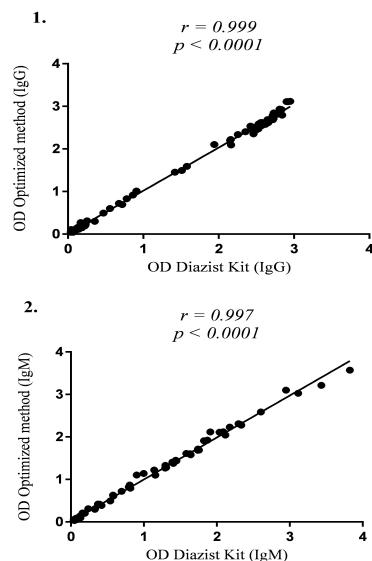

(تصویر شماره ۵: همبستگی نتایج سنجش IgG (۱) و IgM (۲) در نمونه‌های مورد مطالعه با دو روش الایزای طراحی شده در این مطالعه و کیت تجاری مورد تایید وزارت بهداشت (شرکت دیاژیست). نمونه مورد مطالعه که شامل ۶۱ نمونه سرم افراد بهبود یافته از بیماری COVID-۱۹ (سرم مثبت) و ۳۱ نمونه سرم افرادی که فاقد آتنی بادی اختصاصی بوده‌اند، با دو روش الایزای طراحی شده و کیت تجاری مورد تایید وزارت بهداشت (شرکت دیاژیست) مورد سنجش قرار گرفت. جذب نوری (OD) به دست آمده از نتایج الایزای هر دو روش در آزمون آماری همبستگی پرسون با هم مقایسه شدند).

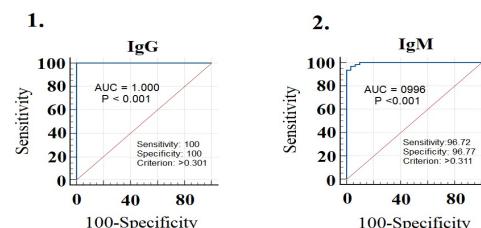

(تصویر شماره ۶: منحنی راک (ROC Curve) روش طراحی شده در مقایسه با کیت تجاری ۱. سنجش IgG ۲. سنجش IgM

طراحی شده بر اساس پروتئین S و پروتئین N نشان دهنده حساسیت مشابه در آنها بوده است(۲۱۲۲). در مطالعه Wangbing Liu و همکاران نشان داده شد که N دو روش ELISA طراحی شده بر اساس پروتئین های N و S تفاوتی در شناسایی IgG از خود به نمایش نگذاشت، این در حالی است که حساسیت این روش با پروتئین های S برای شناسایی IgM به طور معنی داری بیشتر از روش طراحی شده با پروتئین های N بوده است(۲۲). با توجه به عدم وجود تفاوت معنادار در نتایج مطالعات مختلف در استفاده از پروتئین N و S در طراحی کیت ELISA برای اندازه گیری آنتی بادی های IgG و IgM علیه SARS-CoV-2، در مطالعه حاضر تصمیم به استفاده از پروتئین N گرفته شد. به همین دلیل به جهت مقایسه صحیح نتایج حاصل از این مطالعه از کیت شرکت دیازیست که از پروتئین N در طراحی کیت استفاده شده است، به عنوان کنترل استاندارد انتخاب گردید. با این حال، به نظر می رسد استفاده تلفیقی از هر دو پروتئین S و N موجب می شود درصد نتایج مثبت افزایش یابد. همچنین، در مطالعه Jie Xiang و همکاران که به بررسی تشخیص SARS-CoV-2 ELISA و ایمونو کروماتو گرافی طلا کلولی دال (colloidal gold-immunochromatographic assay) پرداختند، نشان داده شد که حساسیت تشخیص ۸۷/۳ به صورت ترکیبی IgG و IgM ELISA و GICA درصد، و حساسیت تشخیص ترکیبی GICA IgG و GICA IgG، ۸۲/۴ درصد بود. همچنین بین حساسیت روش های ELISA و GICA (IgM + IgG) تفاوت معنی داری وجود نداشت(۲۳). با این حال، حساسیت و ویژگی روش ELISA طراحی شده در این مطالعه در مقایسه با کیت تجاری مورد تایید برای سنجش IgG ۱۰۰ درصد و برای سنجش IgM بالای ۹۶ درصد گزارش شده است. تفاوت در میزان حساسیت گزارش شده در مطالعه حاضر و مطالعه Jie Xiang می تواند به دلیل تفاوت در کیت استانداردی که برای مقایسه نتایج انتخاب شده است، باشد.

و ارزیابی سابقه ابتلای فرد به ویژه در افرادی که بیماری بدون علامت داشتند یا در زمان بیماری امکان انجام تست مولکولی برای آنها فراهم نبوده است، مفید است. انجام همزمان تست های مولکولی و سرولوژیکی به طور معنی داری موجب افزایش حساسیت و صحت تشخیص SARS-CoV-2 می شود(۱۸۱۹). انجام همزمان تست های سرولوژیکی در مواردی از جمله نتایج منفی کاذب در تست مولکولی، تطابق نداشتن نتایج تست مولکولی با CT-Scan و تست های عالیم دیگر، نداشتن همخوانی دو تست مولکولی با هم به دلیل نتیجه مثبت یا منفی کاذب یکی از دو تست، می تواند کمک کننده باشد. همچنین با توجه به این که به طور میانگین میزان ژنوم ویروس از روز یازدهم روند کاهشی و میزان تولید آنتی بادی در همین زمان روند افزایشی می یابد، همراهی تست های مولکولی و سرولوژیک روند تشخیص را کارآمدتر می کند. امروزه در تشخیص بسیاری از عفونت ها و همچنین در بررسی حضور آنتی ژن ها و آنتی بادی های ویروسی از تست های سرولوژیک بر پایه ELISA استفاده می شود. از این رو بیماری COVID-19 نیز از این قاعده مستثنی نیست. امروزه کیت های تجاری متعددی برای اندازه گیری سطوح آنتی بادی IgM و IgG به طور غیر مستقیم در خون طراحی و تولید شدند. مطالعات محدودی حاکی از این هستند که کیت های سنجش آنتی بادی IgM و IgG بر پایه SARS-CoV-2 مبتنی بر ELISA بیش از ۹۵ درصد ویژگی را برای تشخیص این بیماری دارند(۲۰). نکه قابل توجه در طراحی این کیت ها نوع آنتی ژن استفاده شده در این کیت ها است که غالباً بر پایه پروتئین S و N می باشند. در همین راستا، در مطالعه ای که روی بیماران مبتلا به SARS انجام گرفت، تفاوت معنادار تولید آنتی بادی علیه پروتئین S و N را نشان دادند، به طوری که پاسخ آنتی بادی علیه پروتئین N بالاتر از پروتئین S بود(۲۱). این در حالی است که در مطالعات اندک انجام شده درباره SARS-CoV-2 چنین اختلافی گزارش نشده است و مقایسه حساسیت تست های سرولوژیک

تأثیر تست‌های سرولوژیک در جنبه‌های مختلف مرتبط با کنترل اپیدمی SARS-CoV-2، استفاده صحیح و به جا از این تست‌ها به مدیریت بهتر این اپیدمی کمک می‌کند.

سپاسگزاری

به این وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به دلیل تصویب اعتبار پژوهشی لازم برای این طرح، تقدیر و تشکر می‌گردد (کد طرح: ۷۵۶۰ سامانه سیات).

در نهایت، اگرچه تست‌های سرولوژیک به تنها بی ابزاری مناسب برای تشخیص نیست، همراهی آن‌ها با تست‌های مولکولی موجب افزایش صحت و حساسیت در تشخیص بیماری شده که می‌تواند به ایزوله کردن به موقع افراد مبتلا و جلوگیری از گسترش بیماری منجر شود. ذکر این نکته نیز بسیار مهم است که تست‌های سرولوژیکی مثبت، نشان دهنده ایمن شدن و مصونیت قطعی افراد نیست، چرا که هنوز مصونیت زا بودن و مدت زمان پایداری پاسخ ایمنی مصونیت زا مشخص نشده است. با توجه به

References

- Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *lancet* 2020; 395(10223): 507-513.
- Wu D, Wu T, Liu Q, Yang Z. The SARS-CoV-2 outbreak: what we know *Int J Infect Dis* 2020; 94: 44-48.
- Taghiloo S, Aliyali M, Abedi S, Mehravaran H, Sharifpour A, Zaboli E, et al. Apoptosis and immunophenotyping of peripheral blood lymphocytes in Iranian COVID-19 patients: clinical and laboratory characteristics. *J Med Virol* 2021; 93(3): 1589-1598.
- Taghiloo S, Soltanshahi M, Aliyali M, Abedi S, Mehravaran H, Ajami A, et al. Cytokine profiling in Iranian patients with COVID-19; association with clinical severity. *Iran J Immunol* 2021; 18(1): 54-64.
- Diao B, Wen K, Chen J, Liu Y, Yuan Z, Han C, et al. Diagnosis of acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection by detection of nucleocapsid protein. *MedRxiv preprint*. 2020.
- Zeng W, Liu G, Ma H, Zhao D, Yang Y, Liu M, et al. Biochemical characterization of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein. *Biochem Biophys Res Commun* 2020; 527(3): 618-623.
- Yurkovetskiy L, Wang X, Pascal KE, Tomkins-Tinch C, Nyallie TP, Wang Y, et al. Structural and functional analysis of the D614G SARS-CoV-2 spike protein variant. *Cell* 2020; 183(3): 739-751. e8.
- Cai Y, Zhang J, Xiao T, Peng H, Sterling SM, Walsh RM, et al. Distinct conformational states of SARS-CoV-2 spike protein. *Science* 2020; 369(6511): 1586-1592.
- Carlson CR, Asfaha JB, Ghent CM, Howard CJ, Hartooni N, Safari M, et al. Phosphoregulation of phase separation by the SARS-CoV-2 N protein suggests a biophysical basis for its dual functions. *Mol Cell* 2020; 80(6): 1092-1103. e4.
- Kumar S, Nyodu R, Maurya VK, Saxena SK. Host immune response and immunobiology of human SARS-CoV-2 infection In: Saxena, S. (eds) *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Medical Virology: From Pathogenesis to Disease Control*. Singapore, Springer; 2020. P. 43-53.
- Jin Y, Wang M, Zuo Z, Fan C, Ye F, Cai Z, et al. Diagnostic value and dynamic variance of serum antibody in coronavirus disease

2019. Int J Infect Dis 2020; 94: 49-52.
12. Machado BAS, Hodel KVS, Barbosa-Júnior VG, Soares MBP, Badaró R. The main molecular and serological methods for diagnosing COVID-19: an overview based on the literature. Viruses 2021; 13(1): 40.
 13. Carter LJ, Garner LV, Smoot JW, Li Y, Zhou Q, Saveson CJ, et al. Assay techniques and test development for COVID-19 diagnosis. ACS Cent Sci 2020; 6(5): 591-605.
 14. Li Z, Yi Y, Luo X, Xiong N, Liu Y, Li S, et al. Development and clinical application of a rapid IgM-IgG combined antibody test for SARS-CoV-2 infection diagnosis. J Med Virol 2020; 92(9): 1518-1524.
 15. Jin Y-H, Cai L, Cheng Z-S, Cheng H, Deng T, Fan Y-P, et al. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version). Mil Med Res 2020; 7(1): 1-23.
 16. van Kasteren PB, van Der Veer B, van den Brink S, Wijisman L, de Jonge J, van den Brandt A, et al. Comparison of seven commercial RT-PCR diagnostic kits for COVID-19. J Clin Virol 2020; 128: 104412.
 17. Ghaffari A, Meurant R, Ardakani A. COVID-19 serological tests: how well do they actually perform? Diagnostics 2020; 10(7): 453.
 18. Liu L, Liu W, Zheng Y, Jiang X, Kou G, Ding J, et al. A preliminary study on serological assay for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in 238 admitted hospital patients. Microbes Infect 2020; 22(4-5): 206-211.
 19. Zhao J, Yuan Q, Wang H, Liu W, Liao X, Su Y, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis 2020; 71(16): 2027-2034.
 20. Hou H, Wang T, Zhang B, Luo Y, Mao L, Wang F, et al. Detection of IgM and IgG antibodies in patients with coronavirus disease 2019. Clin Transl Immunology 2020; 9(5): e1136.
 21. Schnurra C, Reiners N, Biemann R, Kaiser T, Trawinski H, Jassoy C. Comparison of the diagnostic sensitivity of SARS-CoV-2 nucleoprotein and glycoprotein-based antibody tests. J Clin Virol 2020; 129: 104544.
 22. Liu W, Liu L, Kou G, Zheng Y, Ding Y, Ni W, et al. Evaluation of Nucleocapsid and Spike Protein-based ELISAs for 2 detecting antibodies against SARS-CoV2. J Clin Microbiol 2020; 58(6): e00461-e00420.
 23. Xiang J, Yan M, Li H, Liu T, Lin C, Huang S, et al. Evaluation of enzyme-linked immunoassay and colloidal gold-immunochemical assay kit for detection of novel coronavirus (SARS-CoV-2) causing an outbreak of pneumonia (COVID-19). MedRxiv preprint. 2020.